
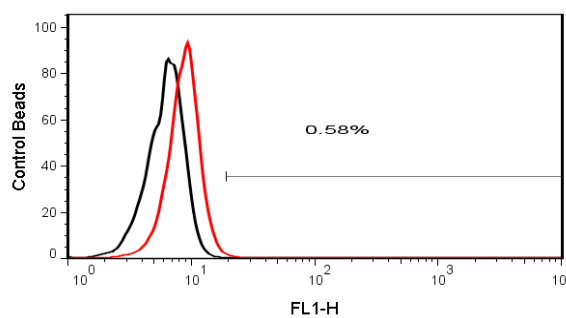


# 抗HLA抗体スクリーニング (Class I & II) 結果報告書

施設名	株式会社リプロセル 臨床検査室			報告日	2015年1月7日
検体標識	123456	管理番号	1501500	担当医名	
検体採取日	2015年1月5日	到着日	2015年1月6日	検査日	2015年1月6日
患者性別	男	患者年齢		検体材料	血清
使用試薬	FlowPRA I & II Screening Test				
備考					


## 解析

### Control Beads

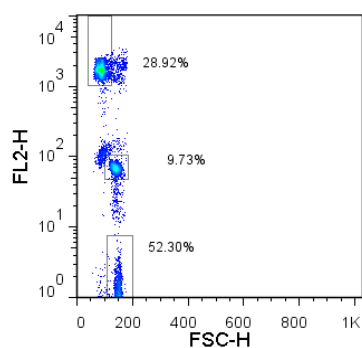


黒 : Negative Control

### Class I

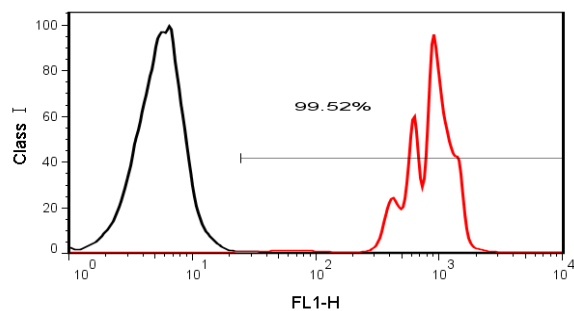

黒 : Negative Control

### Class II

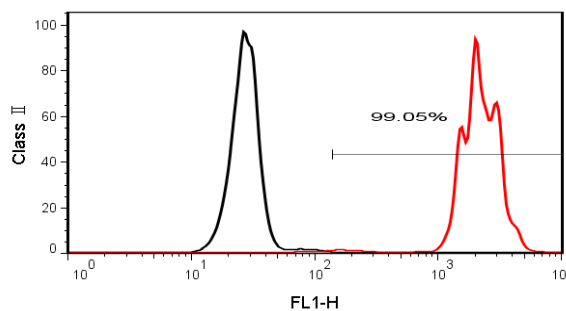

黒 : Negative Control

HLA抗体 (Class I)	陽性
%PRA	99.52

HLA抗体 (Class II)	陽性
%PRA	99.05

コメント